

Kúpna zmluva č. 0609/2016/AM

podľa ust. § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
uzatvorená medzi

Predávajúcim:

Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o.

Sídlo : Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO : 46378979

DIČ : 2023373264

IČ DPH : SK2023373264.

Bankové spojenie : Tatra banka a.s., Bratislava

číslo účtu : (IBAN) SK85 1100 0000 0026 2722 5544

Menom ktorého koná : Ing. Jaroslav Tonkovič, konateľ

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúcim:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N.Jégého Dolný Kubín

Sídlo: Nemocničná 1944/10

026 14 Dolný Kubín IČO: 00634 905

DIČ: 2020563754

IČ DPH: SK2020563754

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN) : SK61 8180 0000 0070 0048 1029

Menom ktorého koná:

PhDr. Jozef Mintál, MBA riaditeľ DONsP

(ďalej len "kupujúci")

I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Predávajúci vyhlasuje, že je dovozcom, distribútorom a opravcom medicínskej techniky v Slovenskej republike.

1.2 Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený túto zmluvu na predmetnú vec kúpy uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.

1.3 Kupujúci vyhlasuje, že je podľa príslušných právnych predpisov, alebo iných predpisov oprávnený uzavrieť túto zmluvu a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.

II.

Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať dojednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje dojednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa tejto zmluvy; kupujúci touto zmluvou a za podmienok v nej stanovených kupuje od predávajúceho do svojho vlastníctva tovar „Anestéziologický monitor vitálnych funkcií GE Healthcare ProCare B40 „ bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 k tejto zmluve (ďalej aj ako "predmet kúpy").

III.

Kúpna cena

3.1 Kúpna cena predmetu kúpy bola stanovená na základe dohody zmluvných strán a na základe výsledku zadania zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní nasledovne:

Celková cena s DPH : 8832,00,- EUR

Celková cena bez DPH : 7360,00,- EUR

DPH vo výške 20 % : 1472,00 ,- EUR

3.2 Dohodnutá kúpna cena sa rozumie cenou maximálnou, najvyššie prípustnou.

3.3 V kúpnej cene uvedenej v odseku 1 tohto článku je zahrnutá doprava (dodanie na miesto dodania), poistné, balné, clo a DPH, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu kupujúceho a všetky

ďalšie náklady súvisiace s dodaním predmetu kúpy kupujúcemu, jeho uvedením do prevádzky a riadnym používaním na určený účel, ako aj návod k obsluhu, vyhlásenie o zhode a ostatná dokumentácia potrebná na riadne užívanie predmetu kúpy (ďalej len "kúpna cena"). Kúpna cena je dohodnutá ako pevná a konečná, ktorú nie je prípustné zmeniť.

3.4 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane DPH za dodaný predmet kúpy na základe faktúry vystavenej predávajúcim za podmienok dohodnutých v článku 4 tejto zmluvy.

3.5 Predávajúci vyhlasuje, že tovar spĺňa technickú špecifikáciu, ktorá je uvedená v súťažných podmienkach a že tovar spĺňa všetky platné právne aj technické normy na použitie na účel, na ktorý je určený, inak je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

IV.

Fakturácia

4.1 Predávajúci vyfakturuje kúpnu cenu za dodaný predmet kúpy kupujúcemu dohodnutú v bode 3.1 tejto zmluvy. Právo k fakturácii vznikne predávajúcemu ihneď po prevzatí predmetu kúpy kupujúcim vrátane všetkých príslušných dokladov vzťahujúcich sa na predmet kúpy a po inštalácii a uvedení predmetu kúpy do prevádzky a zaškolení personálu.

4.2 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru na dohodnutú kúpnu cenu vystavenú predávajúcim na účet predávajúceho, podľa predchádzajúceho bodu tejto zmluvy, ktorej splatnosť je dohodnutá 30 dní od doručenia faktúry. Nevyhnutnou súčasťou faktúry bude dodací list podpísaný kupujúcim (kópia), inak kupujúci nie je povinný faktúru uhradiť.

V.

Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa vzťahujú k predmetu kúpy a ktoré sú nutné k jeho prevzatiu a užívaniu.

5.2 Predmet kúpy musí byť nový a nesmel byť pred uzatvorením tejto zmluvy používaný, inak je kupujúci oprávnený od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy v stave spôsobilom na riadne užívanie, v čo najlepšej kvalite.

5.3 Predávajúci je povinný zabezpečiť riadnu montáž a inštaláciu a uvedenie predmetu kúpy do prevádzky a zaškolenie personálu kupujúceho bezodkladne po dodaní predmetu kúpy.

VI.

Dodacia doba

6.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy a uviesť ho do prevádzky najneskôr do 30 dní od uzavretia tejto zmluvy, t.j. podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami (ďalej len "dodacia doba"). V prípade, že predávajúci poruší svoju povinnosť dodať kupujúcemu predmet kúpy riadne a včas v dodacej dobe podľa predchádzajúcej vety, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý deň omeškania s dodaním predmetu kúpy kupujúcemu riadne a včas (v dodacej dobe).

6.2 Kupujúci je povinný predmet kúpy, ktorý bude dodaný riadne a včas, prijať, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

VII.

Miesto dodania

7.1 Predávajúci dodá kupujúcemu predmet kúpy na oddelenie : **Anestézie a intenzívnej medicíny** Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou Dolný Kubín (ďalej len "miesto dodania").

VIII.

Reklamácia

8.1 Dohodou zmluvných strán, boli dohodnuté nasledujúce doby pre prípadné reklamácie:

- a) kvantitatívna reklamácia - do 30 dní od prevzatia predmetu kúpy v mieste dodania.
- b) kvalitatívna reklamácia - po dobu záruky 24 mesiacov.

IX.

Záruka, záručná doba a servis

9.1 Predávajúci poskytuje na predmet kúpy záruku. Záručná doba na predmet kúpy, ktorý kupujúci od predávajúceho na základe tejto zmluvy prevezme je **24 mesiacov** od dňa prevzatia predmetu kúpy kupujúcim. Predávajúci garantuje technické parametre uvádzané výrobcom a počas dohodnutej záručnej doby zodpovedá za vady a akosť dodaného tovaru. V prípade, že sa po prevzatí predmetu kúpy kupujúcim vyskytnú vady alebo poruchy v záručnej dobe, ich odstránenie je povinný zabezpečiť predávajúci bezplatne na svoje náklady. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej nemohol byť predmet kúpy používaný z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka. Záruka sa vzťahuje na kompletný predmet kúpy, ako i príslušenstvo, bez ktorého nie je možné využívať predmet kúpy v plnej funkčnosti. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol predmet kúpy v oprave.

9.2 Záručný a pozáručný servis sa zaväzuje vykonávať predávajúci.

9.3 Predávajúci sa zaväzuje začať s opravou prípadnej vady alebo poruchy na dodanom predmete kúpy maximálne do 48 hodín od jeho písomného nahlásenia (za písomné nahlásenie sa považuje aj oznámenie elektronickou poštou alebo faxom) a opravu uskutočniť bezodkladne, inak je predávajúci povinný bezodplatne vypožičať kupujúcemu vec s podobnými vlastnosťami a funkciou ako predmet kúpy.

9.4 Ohlásenie vady oznámi za kupujúceho zodpovedná osoba predávajúcemu na tel. číslo : 0903 439 298, 032/7798118, alebo na e-mail: stanislav.prachar@messermedical.sk . Kontaktnou osobou je servisný technik p. Stanislav Prachař.

9.5 Po uplynutí záručnej doby je možné uzavrieť servisnú zmluvu. Predávajúci je povinný po uplynutí záručnej doby vykonať na požiadanie kupujúceho pozáručný servis predmetu kúpy vrátane dodania náhradných dielov na základe objednávky alebo osobitnej zmluvy. Pri neodstránení poruchy do 14 dní od jej nahlásenia, je predávajúci povinný bezodplatne vypožičať kupujúcemu náhradný prístroj s porovnateľnými vlastnosťami a parametrami ako predmet kúpy do odstránenia vady/poruchy.

9.6 Predávajúci sa zaväzuje po dobu 10 rokov od protokolárneho odovzdania predmetu kúpy realizovať servis predmetu kúpy a dodávať kupujúcemu náhradné diely a spotrebný materiál vzťahujúci sa na predmet kúpy, inak je povinný bezodplatne vypožičať kupujúcemu náhradný prístroj s porovnateľnými vlastnosťami a parametrami ako predmet kúpy do odstránenia vady/poruchy alebo do uplynutia dojednanej doby pozáručného servisu.

X.

Ďalšie ustanovenia

10.1 Táto zmluva sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2 Zmeny tejto zmluvy sú možné po vzájomnej dohode zmluvných strán formou číslovaných dodatkov


10.3 Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane dva 2) rovnopisy a predávajúci jeden (1) rovnopis.

10.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.


10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich slobodnej a uváženej vôle, nie v tiesni, alebo z nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz tejto skutočnosti ju podpisujú.

Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.


V Novom Meste nad Váhom, dňa 5. 9. 2016

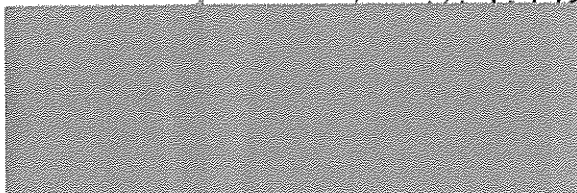

V Dolnom Kubíne, dňa

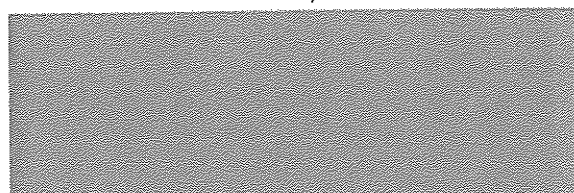

naditeľ DONSIP Dolný Kubín

Messer Medical 
Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o.
Ploštianská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 40 370 979 DIČ: 2023373264
IČ DPH: SK2023373264

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou
MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
026 14 111 111

Príloha č. 1

Cenová ponuka č. 2907/2016m

**Dolnooravská NsP L. N. Jégého
Nemocničná 1944/10
026 14 Dolný Kubín**

Naša značka :
SP/2907/2016

Vybavuje :
Mgr. Štefan Papulák 0911 783 222

Nové Mesto n/V
29.7.2016

Ponuka prístrojového vybavenia pre potreby oddelení OAIM a COS v NsP Dolný Kubín

Dovoľujeme si Vám zaslať cenovú ponuku na nami ponúkané prístroje.

Táto obsahuje:

1 ks anesteziologický monitor vitálnych funkcií GE Healthcare ProCare B40

Platobné podmienky, termín dodania, záruka


Ostávame s pozdravom a veríme, že Vás naša ponuka zaujme. Tešíme sa na prípadnú úspešnú spoluprácu s Vami.

Mgr. Štefan Papulák


GE Healthcare ProCare B40

Skonštruovaný, aby pomáhal poskytovať lepšiu starostlivosť

- Konfigurácia: EKG, NIBP, 2 x IBP, SpO2, 2 x teplota, respirácia, analýza plynov O2, CO2, N2O, anestetiká

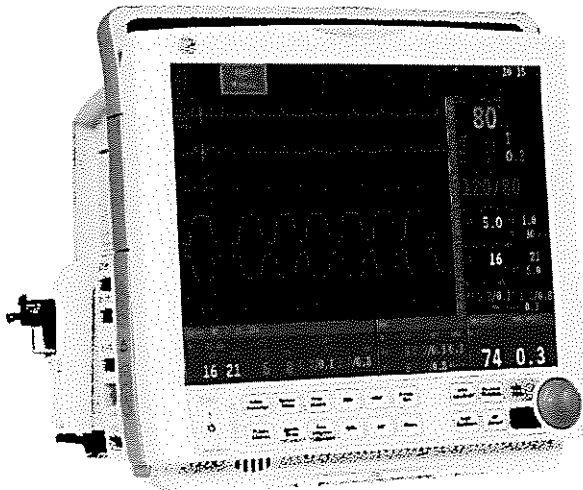


Pacienti s akútnym, život ohrozujúcim stavom potrebujú tú najlepšiu možnú starostlivosť. Modulárny patientský monitor ProCare B40 od GE Healthcare, poskytuje nepretržitý tok informácií k posilneniu kvality klinického rozhodovania pre dospelých, detských aj novorodeneckých pacientov, v rôznych oblastiach starostlivosti.

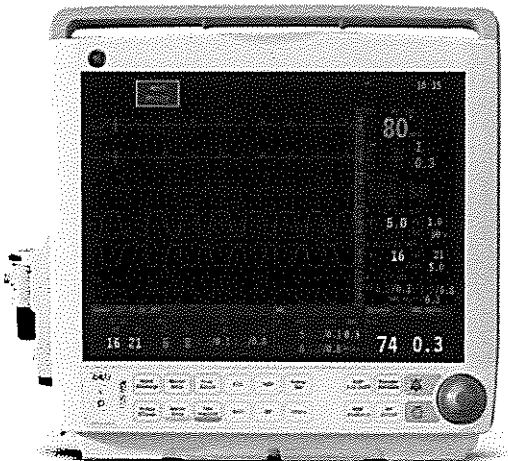

Technický popis prístroja:

- Patientský monitor GE Healthcare ProCare B40 je modulárny monitorovací systém s 12,1" TFT farebnou obrazovkou .
- Napájanie zo siete 220V/50 Hz , alebo prevádzka na zabudovanom akumulátore po dobu 120 minút (možnosť doplniť druhou batériou)

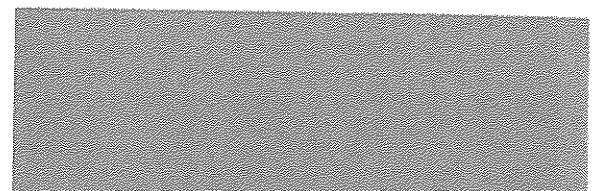

- Možnosť voľby ľubovoľnej konfigurácie šiestich kriviek a štyroch numerických polí vrátane ich farebného odlíšenia.
- Možnosť pripojenia tlačiarne alebo zapisovača (opcia). Monitor má výstup pre pripojenie tlačiarne pre tlač reálnych kriviek, aktuálnych údajov, grafických a numerických trendov a tlač z pamäte udalostí.
- Ovláda sa pomocou otočného kolieska a priamo vyvedených kláves rýchlej voľby. Obrazovka je konfigurovateľná užívateľom.
- Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov od 20 min do 72 hodín s rozlíšením od 10 sekúnd do 1 minúty s možnosťou ich tlače.
- Pamäť udalostí: pamäť pre 400 udalostí s možnosťou zachytenia reálnych kriviek o dĺžke 20 s. Pamäť zahliásených alarmov: ALARM HISTORY
Trend kurzor: možnosť prezerania a tlače vo všetkých typoch trendov.
- Optická aj akustická signalizácia alarmových stavov v 3 úrovniach priority + textová správa príčiny alarmu, priorita vizuálneho zobrazenia alarmov odlišená farebne (farbou blikajúceho osvetlenia) a priorita zvukového alarmu odlišená tónom signalizácie
- Monitor je dodávaný s nastavenými hodnotami alarmov. Alarmy sú aktívne i v prípade, že parameter nie je zobrazený na obrazovke do tej doby, pokiaľ príčina alarmu nie je odstránená. Alarmové hranice sú prehľadne usporiadané v centrálnom poli alarmov.

Meranie EKG:

- (3 alebo 5 zvodov), 12 zvodové EKG ako opcia
- zobrazenie EKG krivky, možnosť výberu zvodu I, II, III, aVR, aVL, aVF
- zobrazenie EKG krivky, súčasne 3 kanály EKG 1, EKG 2, EKG 3
- meranie srdcovej frekvencie HR
- kontrola funkcie pacemakera
- sledovanie ischémie myokardu
- rýchlosť posuvu krivky 12,5; 25; 50 mm/s
- rozsah merania srdcovej frekvencie 30 – 250 bpm
- nastaviteľné alarmové limity

Kontinuálna analýza ST segmentu:

- Numerické ST dáta sú zobrazené vpravo od druhej stopy EKG
- Možnosť manuálneho nastavenia ST bodu
- Zobrazenie ST QRS komplexu pre každý zvod
- Grafický trend ST hodnôt
- Rozsah merania –
- Nastaviteľné alarmové limity
- Analýza arytmií - asystola, brady, tachy, ventikulárna fibrilácia, ventrikulárna tachykardia


Monitor štandardne sleduje dýchanie:

- Na základe impedančnej respirácie z EKG
- Zobrazenie respiračnej vlny a počtu respirácií
- Rozsah merania 4 – 120 dychov/min
- Nastaviteľné alarmové limity

Meranie pulznej oxymetrie:

- Meranie hodnoty saturácie kyslíkom technológiou Nellcor
- Meranie pulzovej frekvencie HR
- Zobrazenie pletyzmografickej krivky
- Možnosť merania senzorom na prste ruky, nohy, na uchu, alebo u malých detí z dlane alebo chodidla
- Rozsah merania SpO2 40-100 %
- Rýchlosť posuvu krivky 12,5; 25; 50 mm/s
- Nastaviteľné alarmové limity

Meranie NIBP:

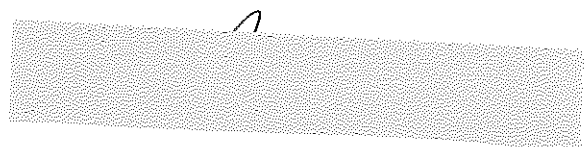

- Automatické meranie s voľbou intervalu cyklovania od 1 min do 4 hodín
- Meranie s manuálnym štartom
- Kontinuálne meranie počas doby 5 minút
- Meranie systolického, diastolického a stredného tlaku
- Venous Stasis = natlakovanie manžety na 80 a podržanie na dobu 2 min pri zavádzaní kanyly
- Nastaviteľné alarmové limity

Meranie IBP:

- 2 vstupy s možnosťou výberu linky invazívneho tlaku z ponúkaného menu (merania arteriálneho, intrakraniálneho (ICP), centrálného venózneho tlaku (CVP), tlaku v pľúcnicí,
- Zobrazenie tlakovej krivky s nulovou a referenčnou úrovňou
- Rozsah merania 40 až 320 mmHg (-5,3 až 42,7 kPa)
- Presnosť merania $\pm 5\%$ alebo ± 2 mmHg, podľa toho, čo je väčšie
- Frekvenčný rozsah 4-22 Hz
- Konvertor citlivosti 5 mV / V / mmHg
- Lhká obsluha, nulovanie IBP vyvedené na funkčnú klávesu

Meranie teploty:

- 2 vstupy, T1, T2, T2 – T1 (rozdiel teplôt)
- Teplota môže byť meraná z rôznych miest, podľa použitého senzoru - esofageálna, nasofaryngeálna, kožná, rektálna, teplota krvi, axilárna
- Monitor má dva vstupy pre meranie teplôt
- Rozsah merania 10 – 45 stupňov Celzia
- Nastaviteľné alarmové limity

Monitorovanie EtCO2

- Sidestream meranie,
- Meranie vydychovanej koncentrácie CO2
- Monitor sa po zapnutí kalibruje automaticky
- Počet dychov RR
- Numerické zobrazenie hodnôt vydychovaného CO2 + grafické zobrazenie /krivka/ koncentrácie CO2
- Možnosť voľby jednotiek %, kPa, mmHg
- Meranie CO2 infračervenou metódou
- Rozsah merania : 0 až 15 %


Frakcie plynov v okruhu

- vdychované a vydychované: O2
- Monitor na kontinuálne sledovanie FiO2 s alarmom
- Krivka koncentrácie O2, numericky FiO2, EtO2, rozdiel Fi-Et
- meranie O2 paramagneticky na celú životnosť monitora, sidestream meranie
- monitor sa po zapnutí kalibruje automaticky
- nastaviteľné alarmové hranice
- Rozsah merania O2 : 0 až 100%
- vdychované a vydychované : N2O, meranie koncentrácie (vdychované a vydychované) pre použité anestetické plyny: halotan, isofluran, sevofluran, enfluran, desfluran
- automatická identifikácia použitého anestetika
- nastaviteľné alarmové hranice .
- Monitor taktiež sleduje:
- Rozdiel medzi vdychovanou a vydychovanou koncentráciou O2
- Minimálnu alveolárnu koncentráciu MAC

Možnosti rozšírenia:

Rozšírenie sa realizuje pomocou akvizíčných modulov GE Healthc

E-modules and CARESCAPE Patient Data Module

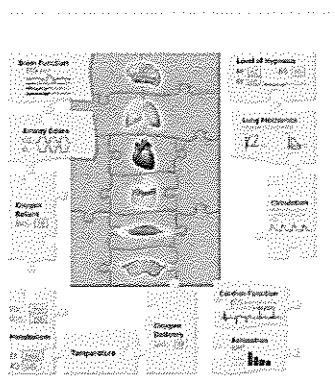

Multiparameter hemodynamic with ECG

- CARESCAPE Patient Data Module
- E-PSM, E-PSMP
- E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

Hemodynamic

- E-COP, E-COPSV
- E-PP, E-PP, E-PT
- E-MASIMO, E-NSATX

Respiratory

- E-miniC, E-CD, E-COV, E-COVX
- E-CAIO, E-CAIOV, E-CAIOVX

Adequacy of Anesthesia

- E-ENTROPY
- E-NMT

Brain

- E-EEG
- E-BIS

Cenová kalkulácia:

Predmet zákazky	Mer. jednot.	Cena v EURO bez DPH	Sadzba DPH %	Cena v EURO s DPH
Anestéziologický monitor vitálnych funkcií	1 kus	7360,00	20	8832,00

Hore uvedená cena je cenou za nový, funkčne bezchybný tovar. V cene sú započítané: clo, dopravné náklady, inštalácia a uvedenie do prevádzky, zaškolenia obsluhy, technická dokumentácia, návod na obsluhu v slovenskom jazyku, opravy a údržba počas záručnej doby a ostatné finančné náklady s tým spojené.

1. Platobné podmienky.

Do 30 dní po dodaní.

2. Čas plnenia.

Termín dodávky do 30 dní od podpisu zmluvy, alebo vystavenia objednávky.

3. Záručné a pozáručné servisné služby .

V dĺžke trvania 24 mesiacov pre predmet zmluvy (spotrebný materiál a batéria 6 mesiacov) odo dňa, kedy bol tovar/zariadenie uvedené do prevádzky. Zárukou za akosť preberá prenajímateľ záväzok, že tovar bude po uvedenú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

V záručnej dobe predávajúci vykoná bezplatne dve záručné prehliadky prístroja (vo výrobcom predpísanom rozsahu podľa servisného manuálu) v ročných intervaloch. Druhú vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstráni všetky zistené vady a nedostatky nezavinené kupujúcim.

Bližšie podmienky záruky za akosť ustanovuje predávajúcim poskytnutý záručný list. Pokiaľ v záručnej dobe dôjde k poruche tovaru/zariadenia, je predávajúci povinný bez nároku na odplatu vadu bez zbytočného odkladu odstrániť s tým, že je povinný začať vykonávať opravu do 24 hodín od oznámenia vady. Predávajúci neposkytuje záruku za vhodnosť použitia tovaru. Zodpovednosť za správny výber a následky použitia tovaru, ako aj za zamýšľané a dosiahnuté výsledky znáša kupujúci. Predávajúci nezodpovedá ďalej za škodu, ktorej vzniku by kupujúci (alebo konečný užívateľ) dokázal predísť.

Zodpovednosť za nedosiahnutú úsporu, škodu z nárokov tretích osôb a ušlý zisk je vylúčená.

Záruka platí za predpokladu, že kupujúci tovar/zariadenie používa a obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií, obsiahnutých v priloženej dokumentácii. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnou a neodbornou manipuláciou a obsluhou. Posúdenie, či tovar/zariadenie bolo/nebolo v okamihu poruchy správne používané náleží kompetentným odborníkom oboch zmluvných strán, ktorí prípadnú vadu preveria a definitívne rozhodnú o ďalšom postupe.

Pred alebo po uplynutí záručnej doby sa zmluvné strany môžu dohodnúť na poskytovaní pozáručného servisu na základe zmluvy o poskytovaní servisu.

V Novom Meste nad Váhom dňa 29.7. 2016

Mgr. Štefan Papulák

Manažér predaja

